


番号: 3404
 氏名: ████████ 様
 〒番号:
 性別: 生年月日:

イモト歯科医院
 〒676-0805
 兵庫県高砂市米田町米田1019-30
 TEL:079-432-6066

日時: 2010/03/29 10:00 装置番号: 0728

測定結果 単位: ppb

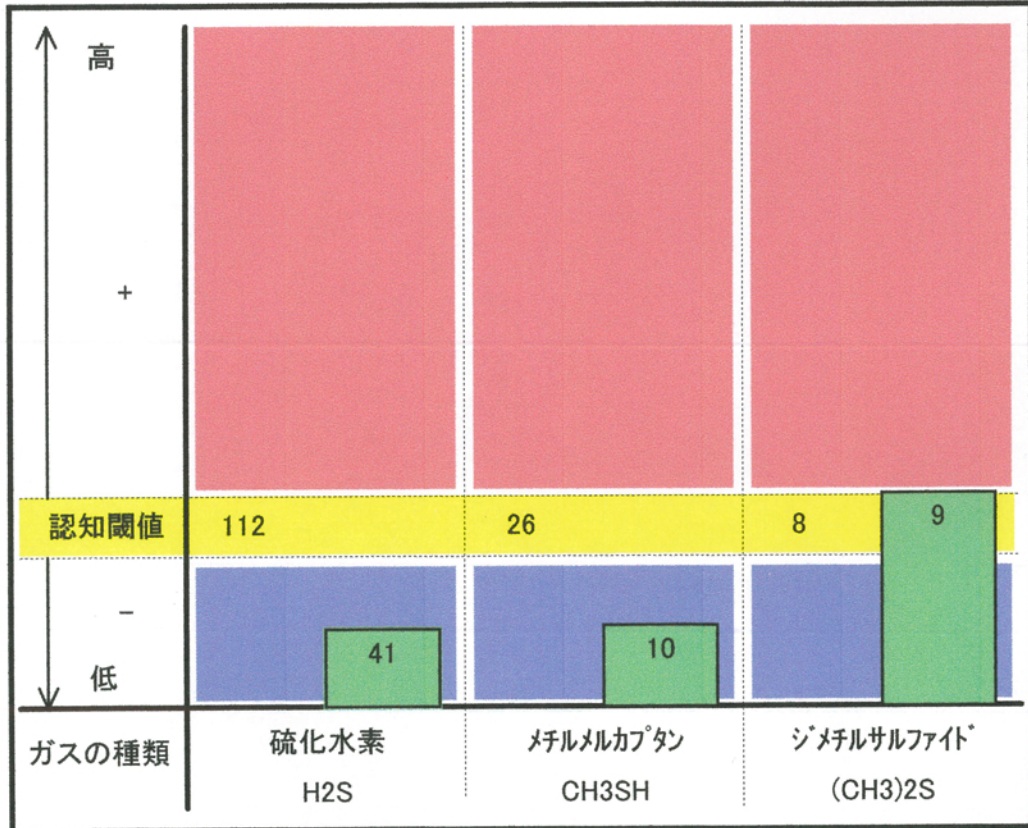

認知閾(いき)値:
 どのような臭いか識別可能な濃度(人間の鼻が臭いを感じる境界域:個人差あり)

前回 (2010/03/24)

H2S : 456 (+)	CH3SH : 531 (+)	(CH3)2S : 12 (+)
---------------	-----------------	------------------

判定

+	+	+	明らかに口臭を感じ明確に不快感を感じる範囲
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	やや口臭を感じる範囲(さほど不快感はない)
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	口臭はあるがほとんど臭いを感じない範囲
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	ほとんど存在しないパターンです。ある種の食品摂取による代謝産物など、いずれも「呼気」に、稀に含まれている場合があります。
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+ 測定値が認知閾値以上
 - 測定値が認知閾値より低い