

番号: 3404

氏名: [REDACTED] 様

フリガナ:

性別: 生年月日:

イモト歯科医院

〒676-0805

兵庫県高砂市米田町米田1019-30


TEL:079-432-6066

日時: 2010/03/24 16:02

装置番号: 0728

測定結果

単位: ppb

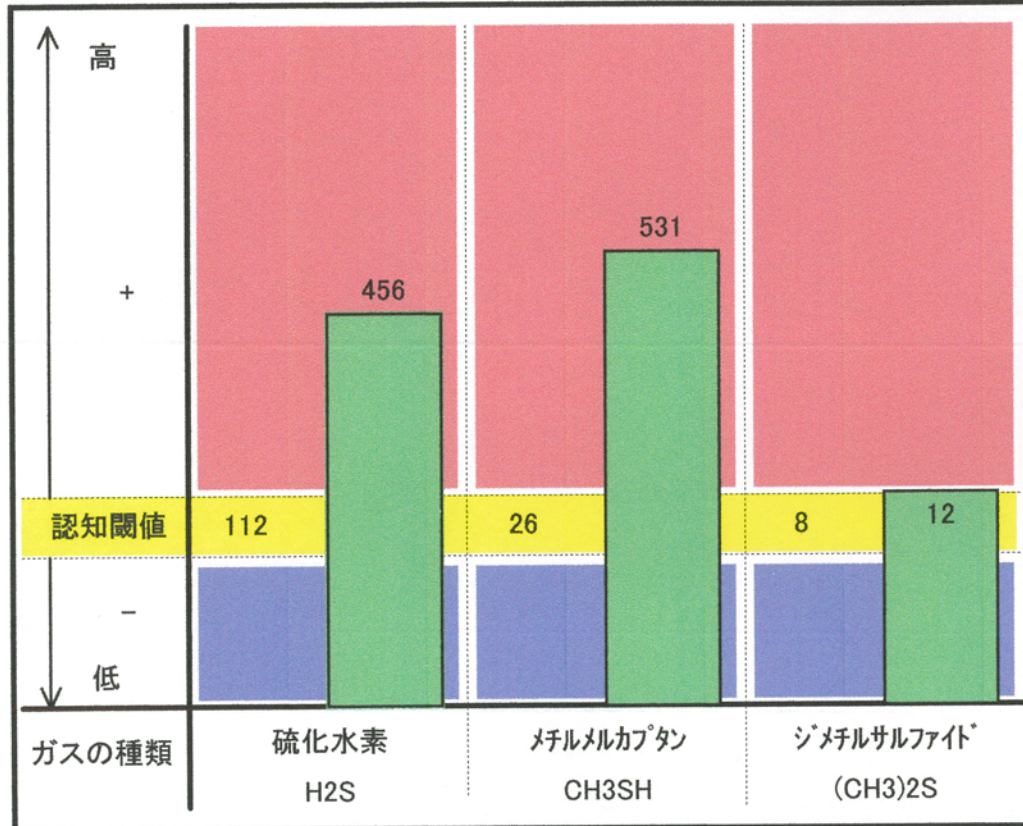

認知閾(いき)値:

どのような臭いか識別可能な濃度(人間の鼻が臭いを感じる境界域:個人差あり)

前回

H2S : 0 (-)	CH3SH : 0 (-)	(CH3)2S : 0 (-)
-------------	---------------	-----------------

判定

+	+	+ or	明らかに口臭を感じ明確に不快感を感じる範囲
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	やや口臭を感じる範囲(さほど不快感はない)
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	口臭はあるがほとんど臭いを感じない範囲
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+	+	+	
-	-	-	
H2S	CH3SH	(CH3)2S	

+ 測定値が認知閾値以上

- 測定値が認知閾値より低い